

# Femme et tabac 2010

## Enquête CO testeur en maternité 2010

Michel Delcroix

Conchita Gomez

Bertrand Dautzenberg

OFT APPRI ANSFT

Remerciement à toutes les SF qui ont répondu



Enquête CO maternité Michel Delcroix Conchita Gomez Bertrand Dautzenberg

<http://www.oft-asso.fr>

## Justificatif

- L'analyseur de CO est un dispositif médical dont l'utilisation est recommandée chez toute les femmes enceintes lors de la première visite et dont l'utilisation doit être répétée lors des visites chez les fumeuses.
- La mesure du CO est un outils de motivation utile à l'arrêt du tabac.
- L'arrêt du tabac améliore le pronostic de la grossesse pour la mère et l'enfant.

# Méthodes

- Un questionnaire a été établie en partenariat par APPRI ANSFT et OFT.
- Le questionnaire a été diffusé aux sages femmes des 550 maternités françaises.
- Les données ont été analysées de façon standard en intégrant les données nationales sur l'activité des maternités publiées.

# Population

- 128 maternités de 68 départements ont répondu à ce jour...

département	Nbre CO testeur
2	1
5	1
6	2
7	1
8	2
10	1
11	2
12	1
13	5
14	3
15	1
17	3
18	1
19	2
22	1
24	1
25	2
27	1
28	4
29	1
31	2
32	1
33	2
34	2
37	1
38	4
39	1
40	1
41	1
42	1
44	2
45	1
46	2
47	1
48	1
50	2
51	1
52	1
54	1
55	1
56	3
57	4
58	1
59	4
61	1
62	3
63	1
64	1
65	1
67	2
68	3
69	3
70	1
71	3
73	1
74	1
75	3
76	2
77	1
78	2
80	1
81	1
83	4
84	1
87	1
91	4
92	3
93	3

ANSFT

OFT

OFFICE FRANÇAIS  
DE PREVENTION  
DU TABAGISME


APPRI

Maternité  
sans  
tabac

Enquête CO maternité Michel Delcroix Conchita Gomez Bertrand Dautzenberg

<http://www.oft-asso.fr>

# Nombre de CO testeurs par maternité

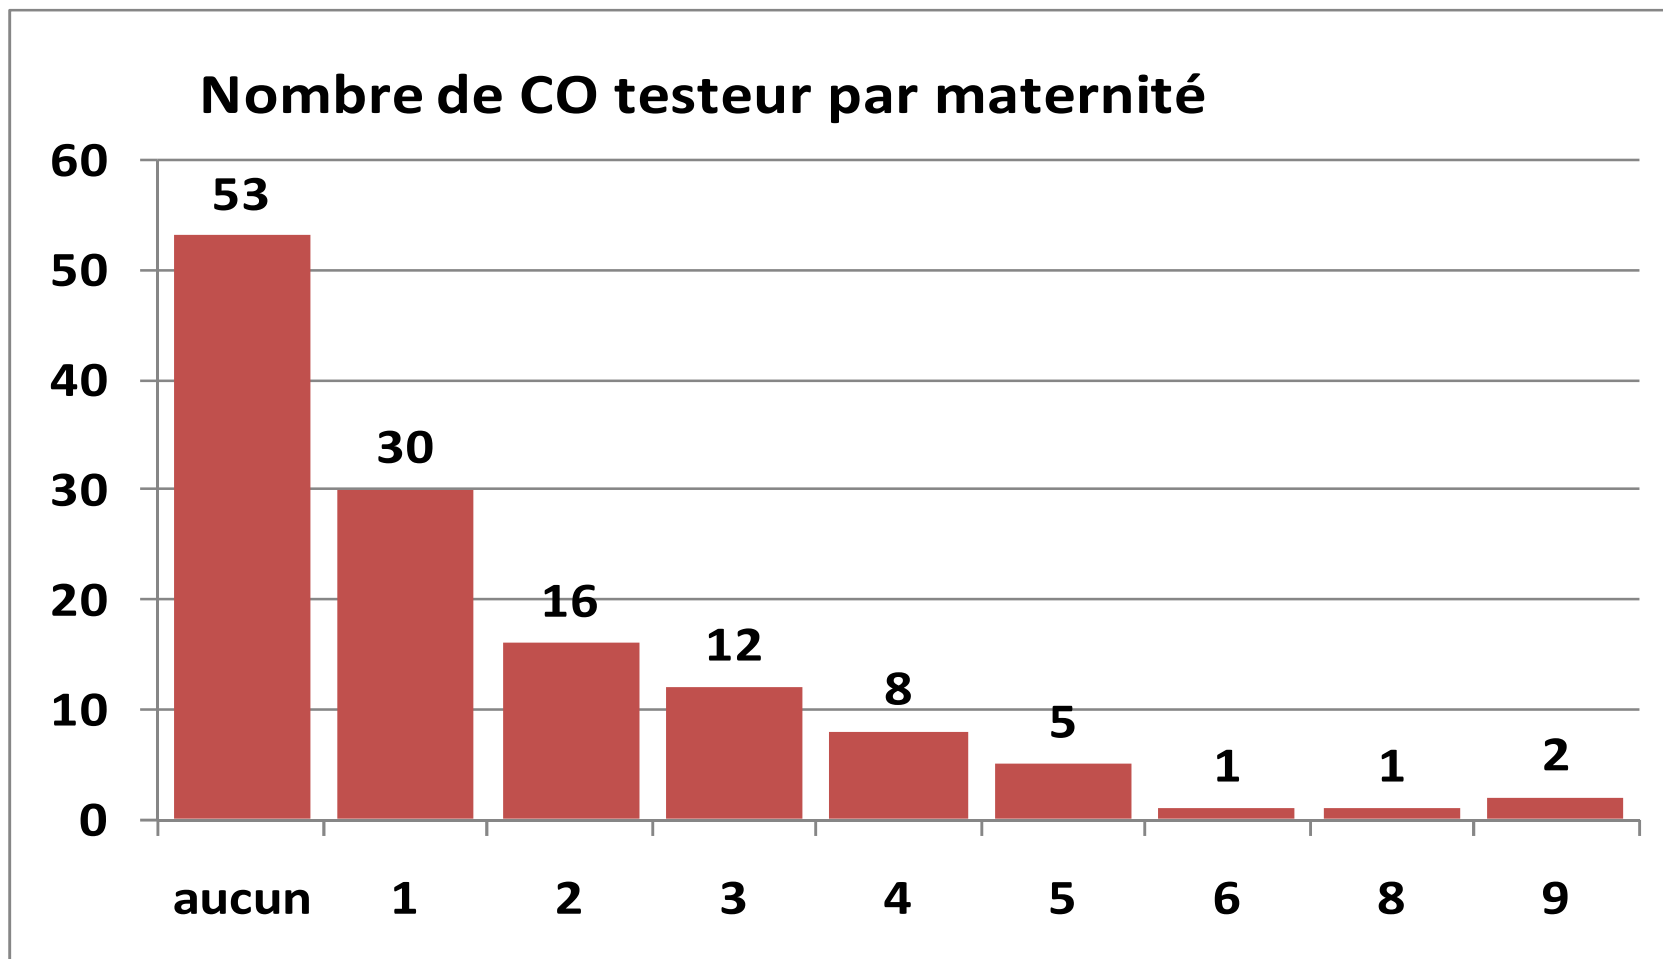

- 41% des maternités n'ont pas d'analyseur de CO

ANSFT

OFT

OFFICE FRANÇAIS  
DE PREVENTION  
DU TABAGISME


APPRI

Maternité  
sans  
tabac

Enquête CO maternité Michel Delcroix Conchita Gomez Bertrand Dautzenberg

<http://www.oft-asso.fr>

# Utilisation du CO testeur

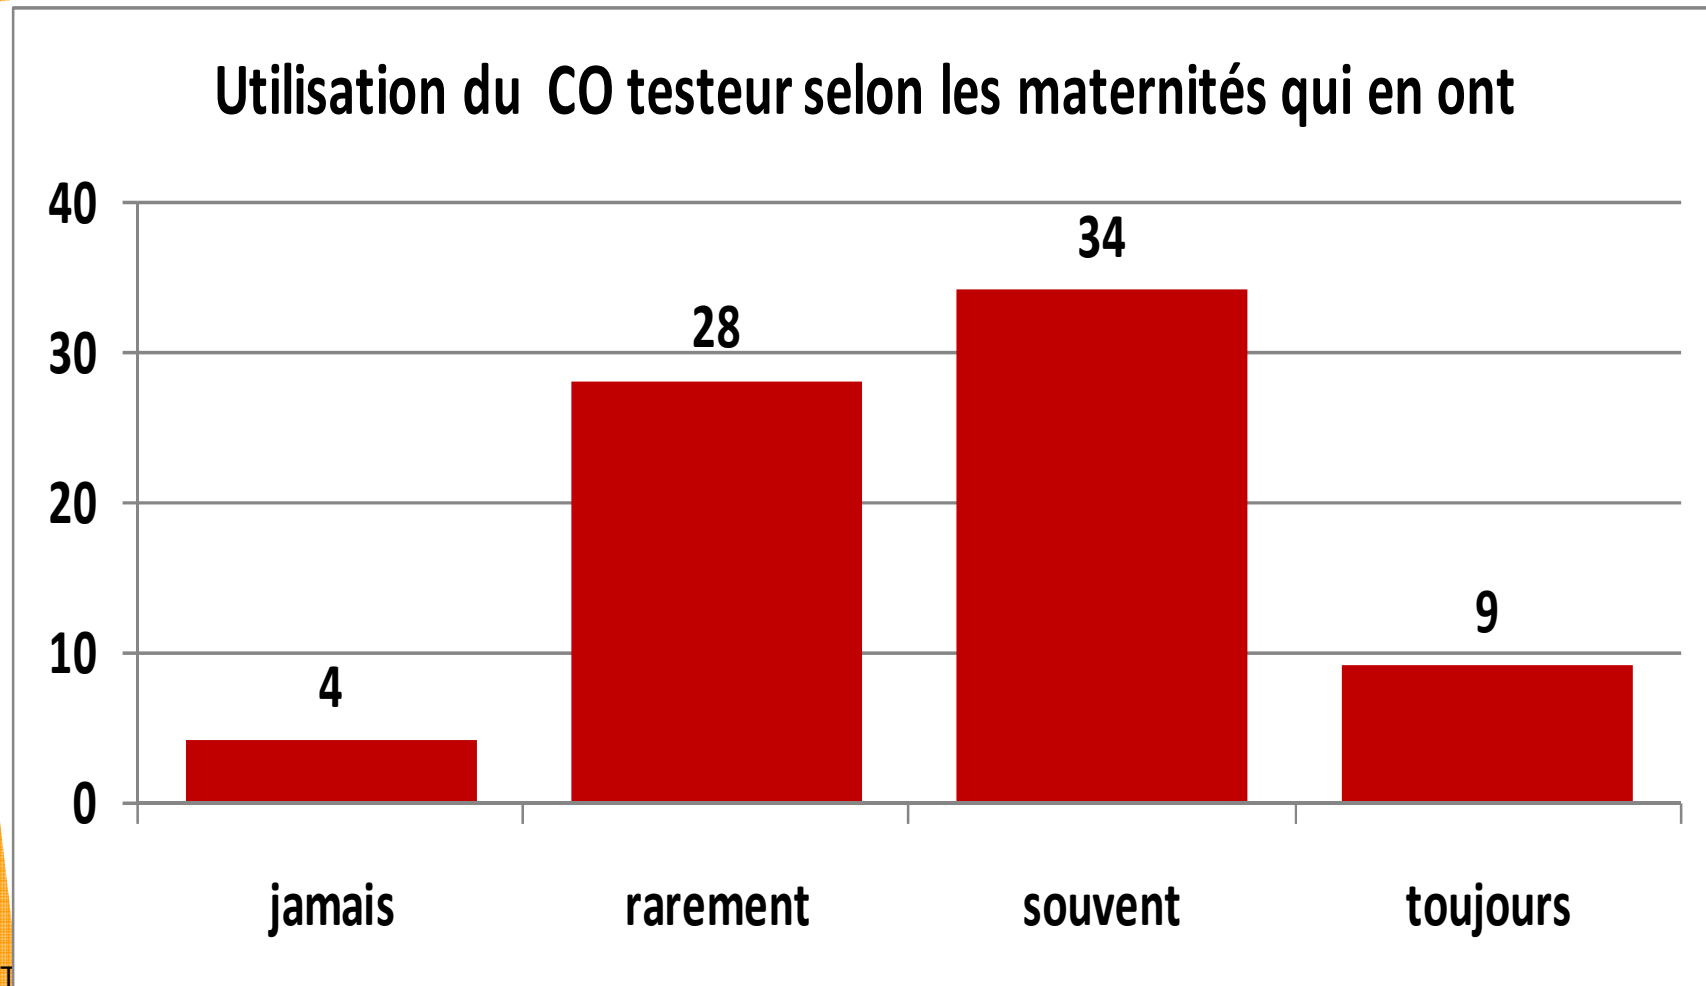

**41% des maternités n'ont pas d'analyseur de CO  
et 5% de ceux qui en ont ne l'utilisent jamais**

Enquête CO maternité Michel Delcroix Conchita Gomez Bertrand Dautzenberg <http://www.oft-asso.fr>

ANSFT


OFT

OFFICE FRANÇAIS  
DE PREVENTION  
DU TABAGISME

APPRI


Maternité  
sans  
tabac

# Nombre de naissances pour un CO testeur

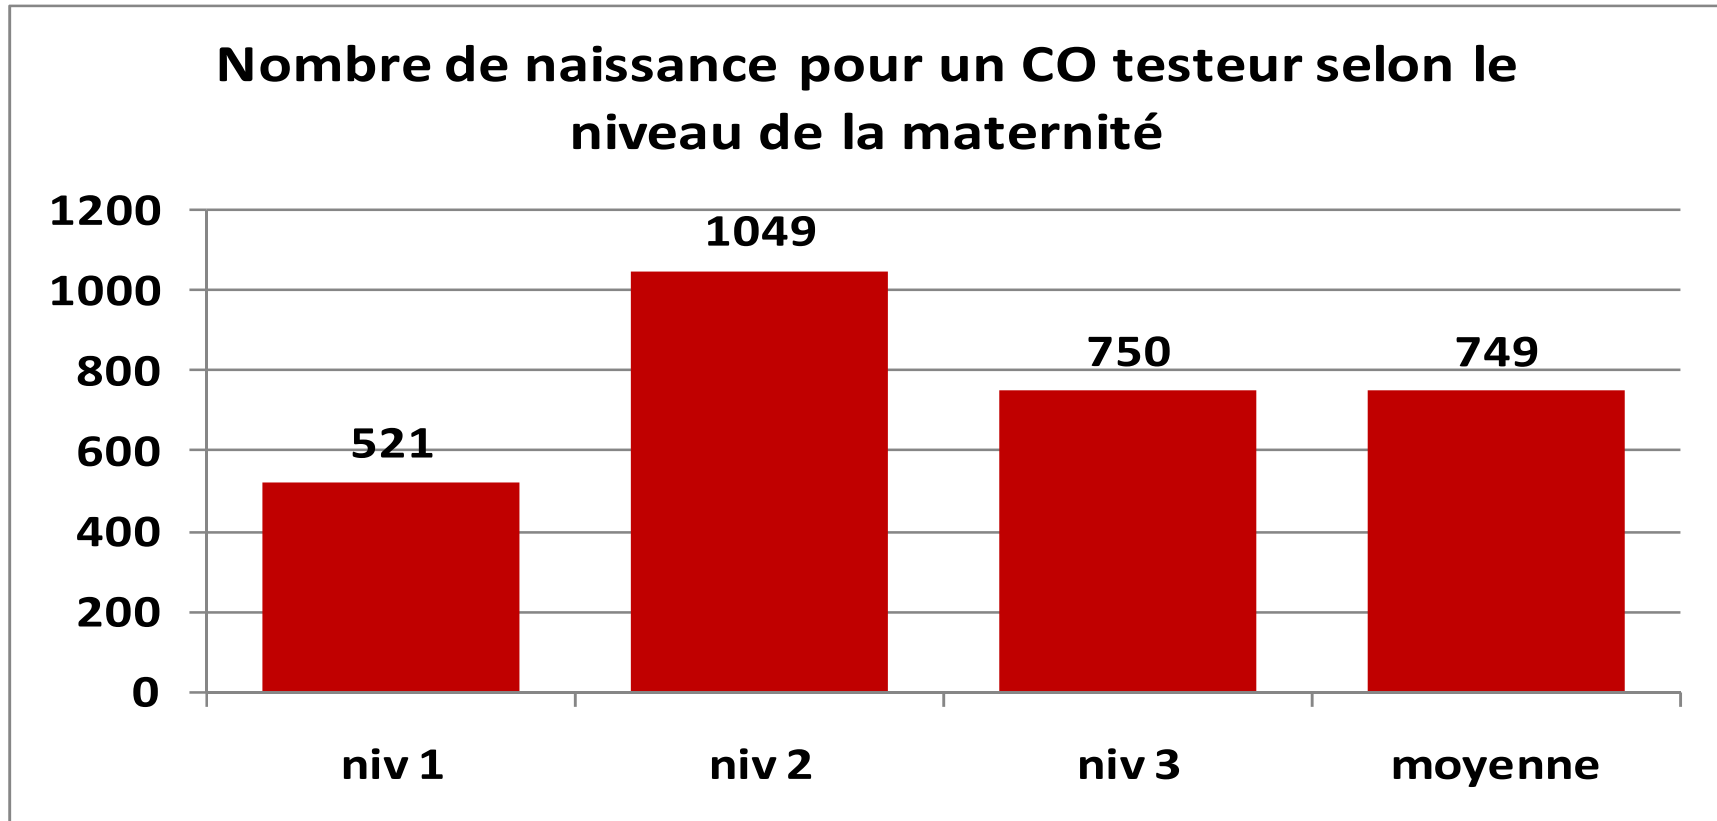


→ Il y a chez les répondants en moyenne :  
**un analyseur de CO pour 750 naissances**

# Relation entre naissances/CO testeur et pourcentage de naissance avec moins de 2,5 kg

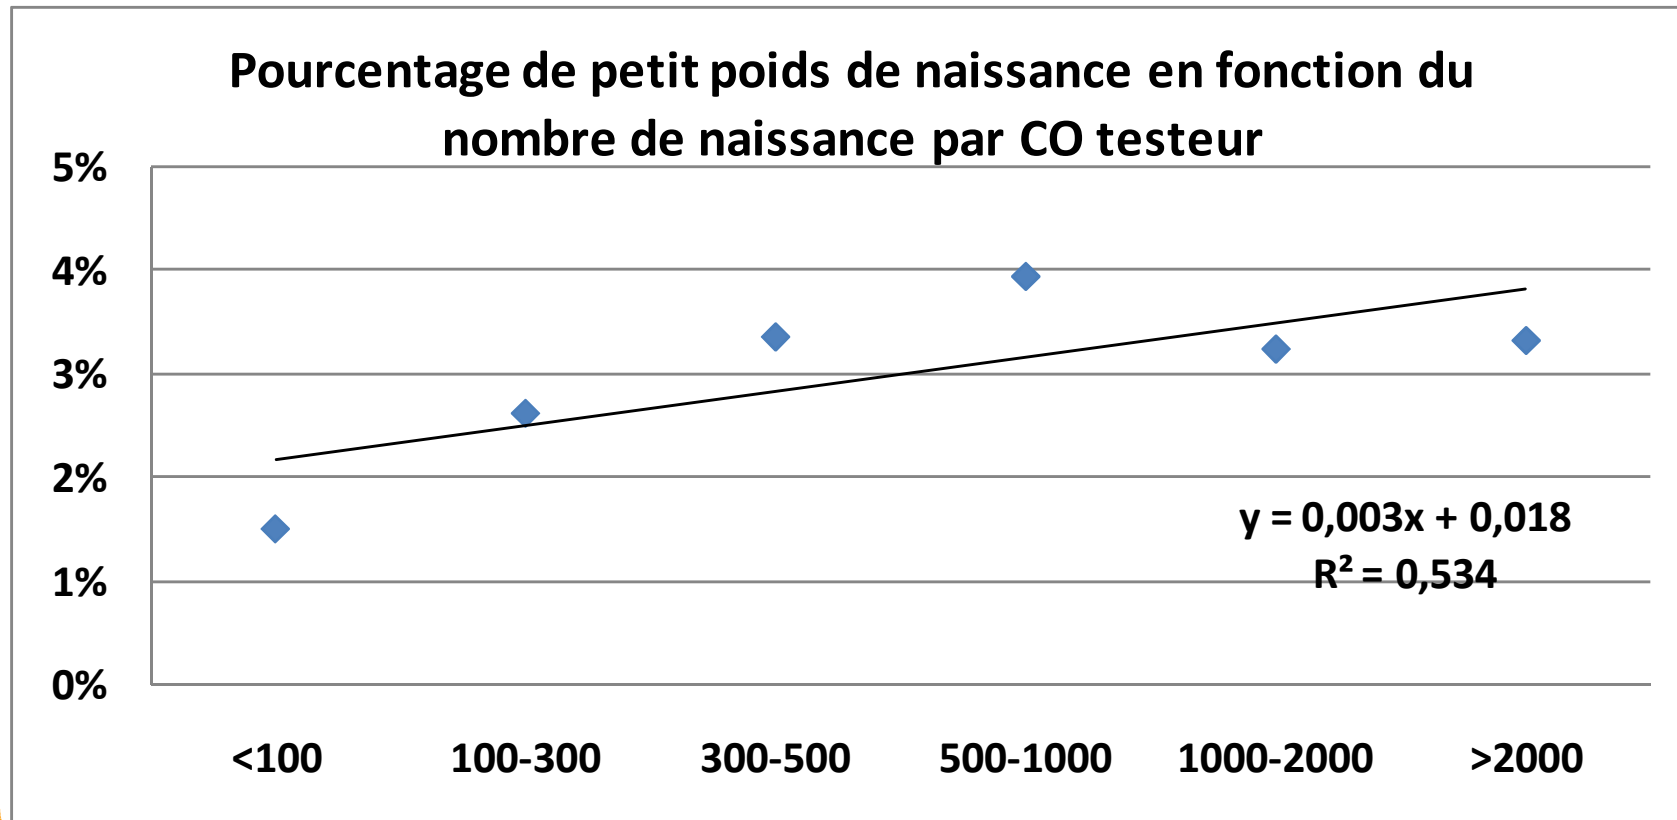


- Plus il y a de CO testeurs, plus le pourcentage de naissances avec un poids de moins de 2,5 kg est important.

# Lien entre pourcentage de césariennes et nombre de CO testeurs

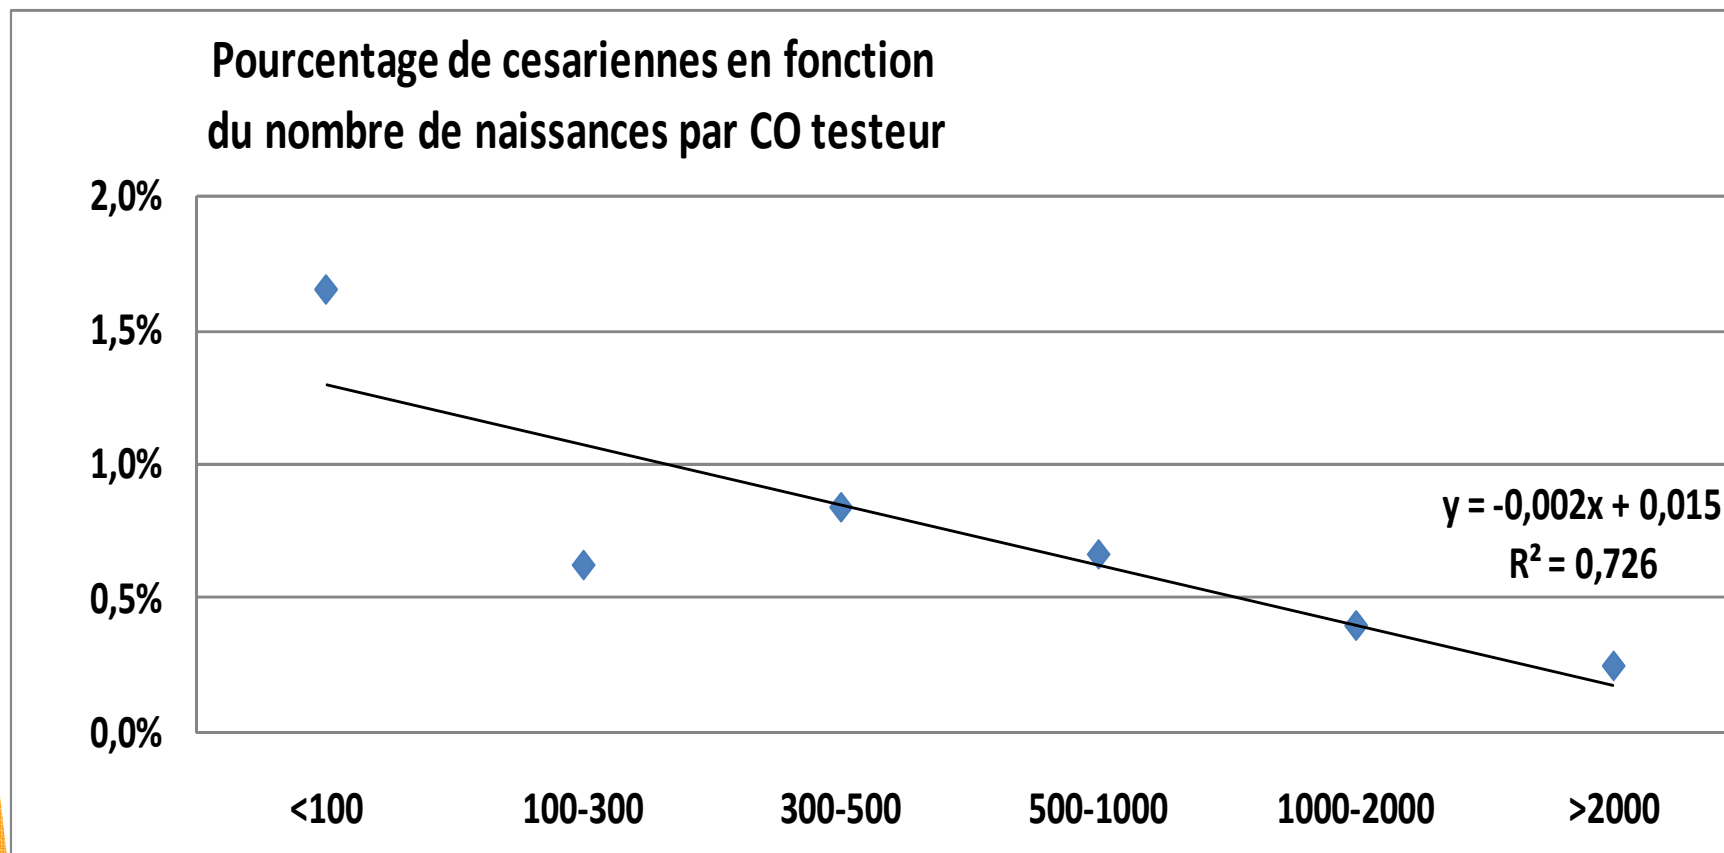

- **Plus il y a de CO testeur dans la maternité (Nbre de naissance par CO-testeur), moins il y a de césariennes.**

# Utilisation des substituts (NRT)

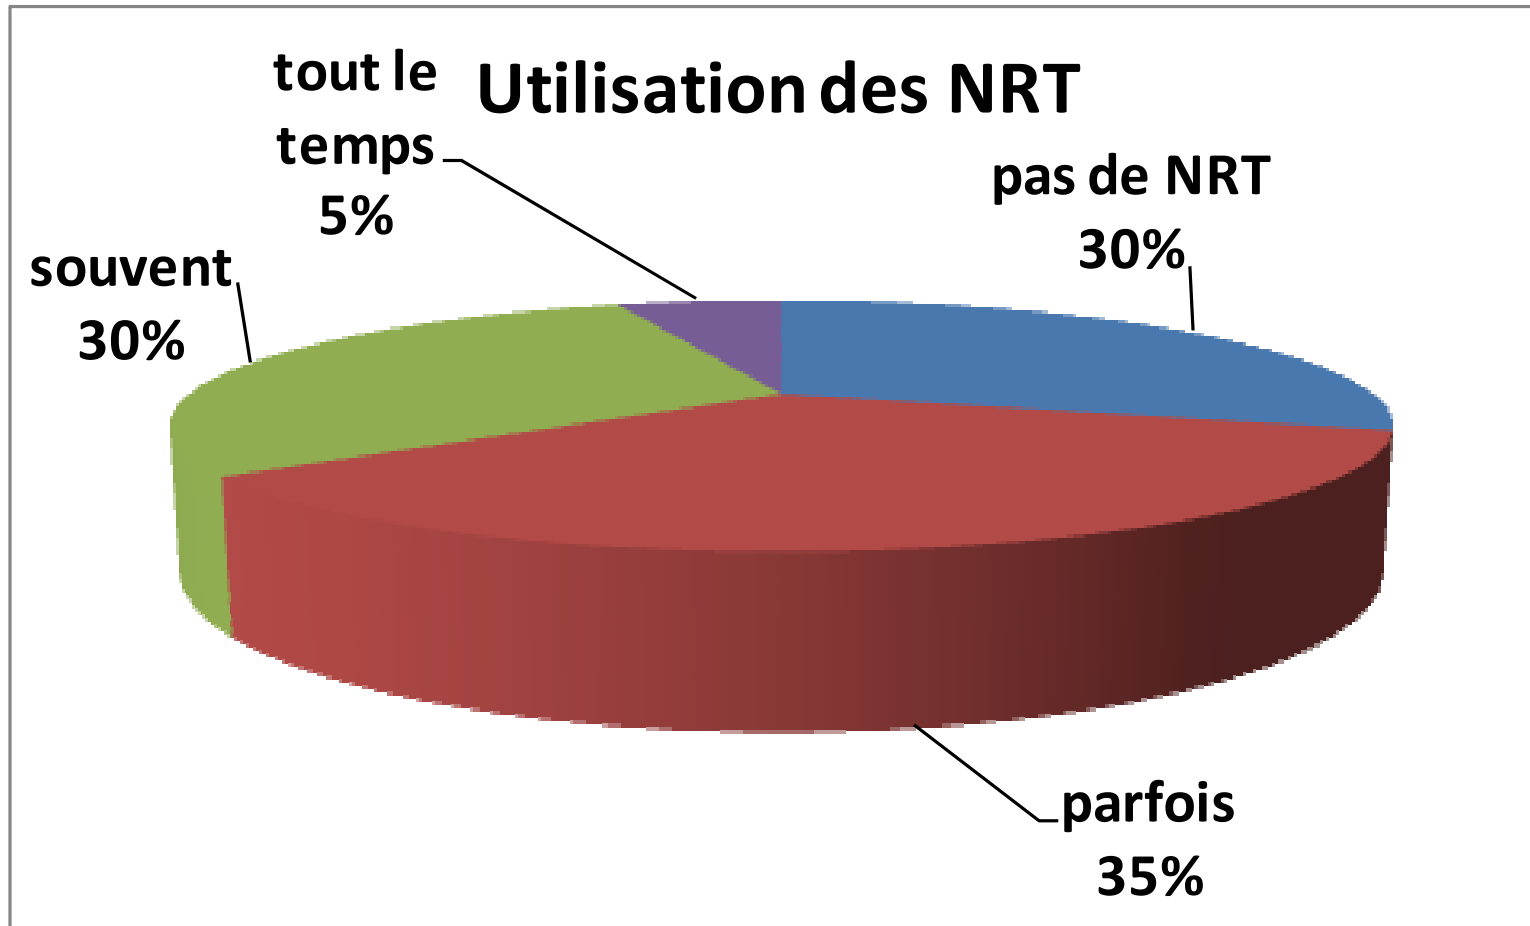

- **30% des maternités n'utilisent jamais de substituts nicotiques !**

ANSFT

OFT

OFFICE FRANÇAIS  
DE PREVENTION  
DU TABAGISME


APPRI

Maternité  
sans  
tabac

Enquête CO maternité Michel Delcroix Conchita Gomez Bertrand Dautzenberg

<http://www.oft-asso.fr>

# Lien entre équipement en CO testeurs et utilisation des substituts nicotiques

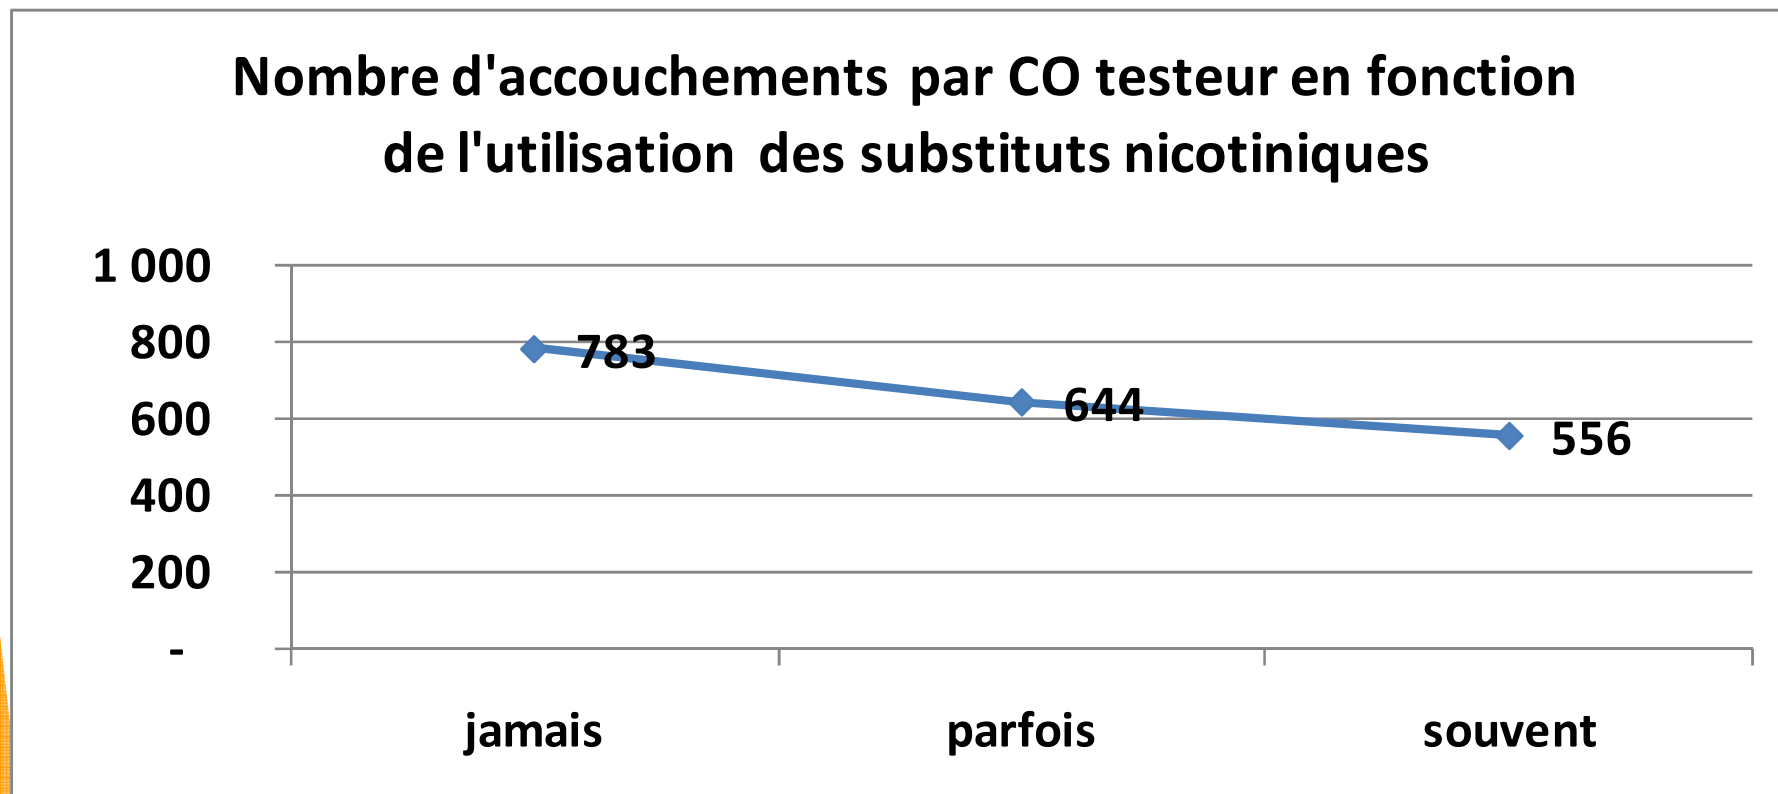

- Là où il y a la plus de CO testeur, il y a le plus souvent d'utilisation des substituts nicotiques.

# CONCLUSIONS

## SOINS PREVENTIFS = SOINS CURATIFS

- CO expire = mesure diagnostique + motivationnelle
- TCC et entretien motivationnel
- TNS = efficience
- Taux d'arrêt = indicateur de résultats

ANSFT

OFT

OFFICE FRANÇAIS  
DE PREVENTION  
DU TABAGISME

APPRI

Maternité  
sans  
tabac

✓ *MERCI BEAUCOUP*

Enquête CO maternité Michel Delcroix Conchita Gomez Bertrand Dautzenberg

<http://www.oft-asso.fr>